

# Комплекс контроля и анализа психофизиологической информации КАПИ

## Исполнение Реакор-Next

Ваш лучший помощник  
в успешном освоении навыков  
психофизиологической саморегуляции



Тренинг навыков оптимального функционирования, стабилизации психоэмоциональной сферы и повышения адаптационных возможностей.




[reacor-next.ru](http://reacor-next.ru)



[medicom-mtd.com](http://medicom-mtd.com)

Исполнение Реакор-Next Комплекса КАПИ выпускается по ТУ-26.51.66-039-24176382-2022, код ОКПД 2 26.51.66.190, декларация о соответствии ЕАЭС N RU ДРУ.РА04.В.53707/22, **не является медицинским оборудованием** и не может применяться по медицинскому назначению.

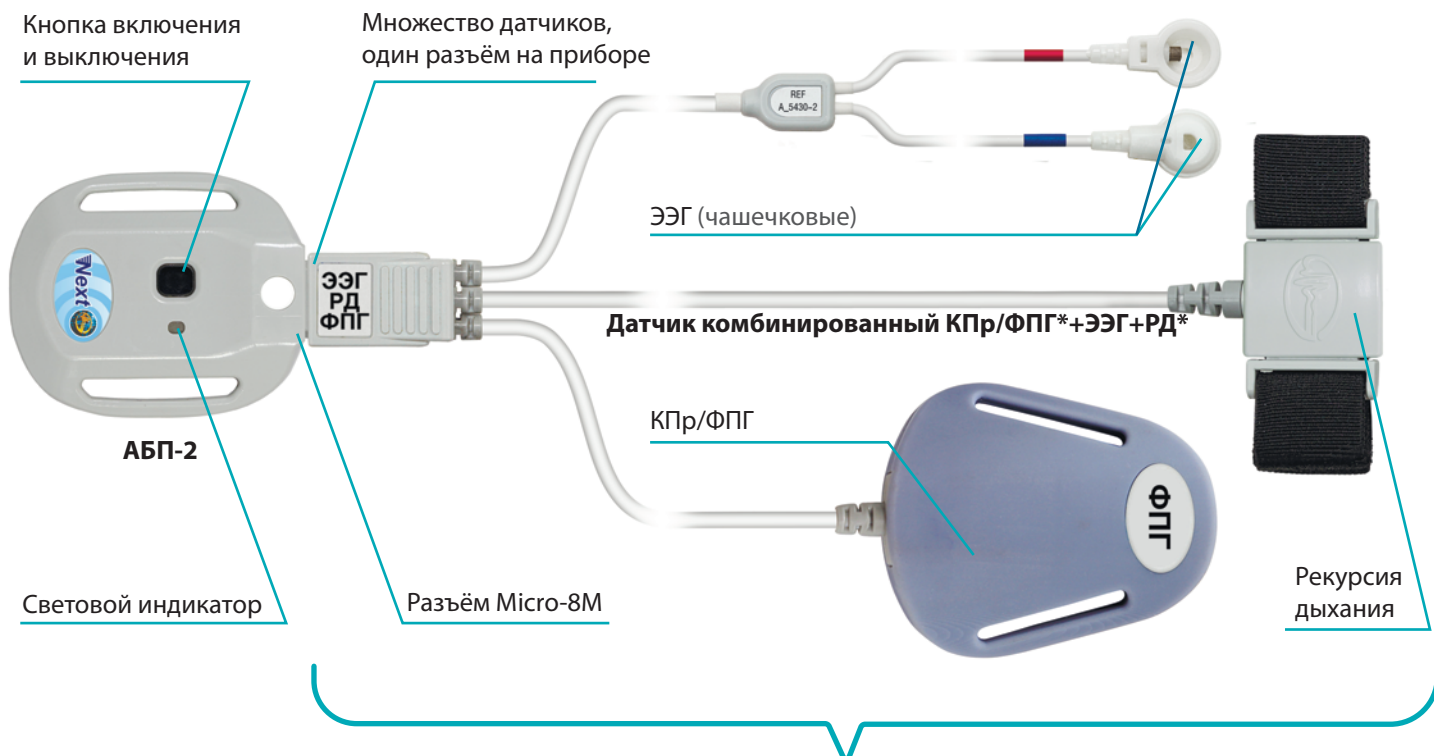

**153** Тренингов в Базовой и Дополнительной библиотеках. С возможностью создания авторских уникальных сценариев тренингов

**35** Видов комбинированных датчиков поставляем с базовой и дополнительной библиотекой тренингов



### Обновлённый удобный подход к проведению БОС-тренинга!

Однозначное соответствие процедуры БОС-тренинга и применяемого в этой процедуре датчика:

**1** Определяемся с типом БОС-тренинга

**2** Подключаем по номеру нужный датчик к АБП-2, и устанавливаем электроды (справочная система – в программе)

**3** Выбираем по номеру процедуру БОС-тренинга (все настройки по физиологическим сигналам уже созданы) и запускаем её.



**МЕДИКОМ МТД**  
Научно – производственно – конструкторская фирма

347900, Россия, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 68  
Тел: +7 (8634) 62-62-42, 62-62-43, 62-62-44  
e-mail: office@medicom-mtd.com  
[www.medicom-mtd.com](http://www.medicom-mtd.com)